

## 取扱説明書

パルスオキシメータ  
オキシシリーズ

# OXiシリーズ

## FINGER PULSE OXIMETER

- ・オキシボーイ S-121
- ・オキシガール S-122
- ・オキシヤング S-123
- ・オキシローザ S-125
- ・オキシフレッシュ S-119

### 安全上のご注意 <お使いになる前によくお読みください>

#### <危険>

- ・本製品を装着したままMRI検査やCT検査を行わないでください。
- ・アラームを必要とする状況で使用しないでください。デバイスにはアラームが付いていないため連続での測定にはご使用いただけません。
- ・本製品は補助的に使用し、他の臨床兆候および症状を評価する方法と併せて使用してください。
- ・可燃性ガス及び高濃度酸素雰囲気内では使用しないでください。爆発または火災発生の危険性があります。
- ・測定箇所に疾患、障害、その他医学的な問題がある場合は、医師に相談の上使用してください。
- ・血圧計のカフ、動脈カテーテル、血管内ライン等が装着されている場合は、反対の腕にセンサーを装着してください。
- ・子供の手の届くところに保管しないでください。
- ・幼児・子供が電池を飲み込む恐れがありますので、電池交換時以外は電池カバーを取り外さないでください。
- ・高気圧酸素治療装置内では使用しないでください。爆発または火災発生の危険性があります。

#### <警告>

- ・無呼吸モニターの用途で本製品を使用しないでください。
- ・以下の場合は正しく測定できないことがあります。  
ヘモグロビン機能不全、低血圧、血管収縮、無気力症、低体温症、弱脈、低灌流、心拍停止またはショック症状
- ・測定中に被験者が動くと、本製品の測定精度に影響を与える場合があります。
- ・被験者によっては安定した測定値が得られないことがあります。その場合は本製品を使用しないでください。
- ・本製品は患者自身、あるいは、使用訓練を受けた人が使用してください。使用前には、医療専門家に相談してください。
- ・循環機能の状態および皮膚に異常が発生していないか確認するため、機器を取り付けている部位を頻繁に確認してください。
- ・血行不良による手足の冷えがあると、測定できない場合があります。その場合は、指をよく温めると、よくなるかもしれませんが、もしくは測定部位を変えてください。
- ・正しいセンサー位置を保ち皮膚を傷つけないために、長時間の装着はしないでください。
- ・本体・付属品に、液体を塗布、注入またはこぼしたりしないでください。
- ・本製品のクリーニングには、腐食剤、研磨剤は使用しないでください。
- ・本製品は精密医療機器です。
- ・測定部位にマニキュア、ハンドクリーム、ハンソウコウ等測定を妨げるものを塗ったり貼ったりしないでください。正確な測定ができなくなります。
- ・1部位に対する使用可能時間は最大4時間です。4時間を超えた使用や過度の加圧は、傷病の原因となる場合があります。
- ・強磁場環境下での使用はしないでください。
- ・指定外の電池を使用しないでください。

#### <注意>

- ・必ず取扱説明書に従って正しくお使いください。
- ・分解、改造および修理は行わないでください。
- ・測定した数値は自己判断せず医師の指示に従ってください。
- ・機器に異常が見られた場合には使用しないでください。
- ・落下などの強い衝撃を与えないようにしてください。故障の原因になります。

### 製品の概要

- ・本製品は、家庭、医療機関、搬送時における、成人の血中酸素飽和度 (SpO<sub>2</sub>) および脈拍を測定するパルスオキシメータです。本製品は、静止状態にある患者 (指の太さ 0.8cm ~ 2.3cm) の測定が想定されています。
- ・本製品は、使用環境に応じて血中酸素飽和度および脈拍の測定に必要なデータ量を自動的に調整します。被験者が通常の静止状態にある場合は8拍~10拍で測定しますが、周辺光や電磁波障害のある環境での測定、および低灌流や静止状態にない場合は測定時間が長くなります。

### 製品各部の名称


有機ELディスプレイ

ボタン:表示切替/設定



ストラップ穴


電池カバー



### フロントパネルの説明

脈波波形

脈拍と脈拍の強さを  
波形で表します。



電池残量表示


電池の残量情報を表しています。

血中酸素飽和度 (%SpO<sub>2</sub>)

血中酸素飽和度のパーセンテージを  
表しています。

脈拍数

1分間あたりの脈拍数を表しています。



脈拍強度表示バー

脈拍と脈拍の強さを表します。

### 記号と表示

#### 定格銘板記載マークの説明 (本体裏シール部)



注意 取扱説明書を参照



BF形装着部 (除細動保護ではない)

(青色表記)

### 付属品

1. 単4形アルカリ乾電池 (AAA) 1本
2. 取扱説明書 (保証書兼用)
3. 添付文書


### ご使用前の準備

- ・本製品のフロントパネルには保護用のプラスチックシートが付いています。有機ELディスプレイの性能を最大限にするため、プラスチックシートを剥がしてお使いください。
- ・測定を開始する前には電池の残量が十分にあるか、また、設定が正しいか必ず確認してください。そうでない場合は、以下を参照してください。

### <電池の確認、交換>

電池を交換する際は、本製品の電源が切れているか確認してください。

本製品の電源は、単4形アルカリ乾電池1本です。電池カバーの「0000」マークをスライドさせ電池カバーを外し、新しい電池を取り付けてください。

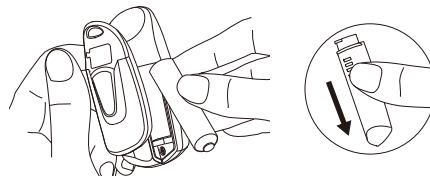

### <各種設定方法>

設定モードへ移行するには、測定中 (指挿入後) は「マーク」を約1秒間長押し、測定前 (指挿入前) はボタンを1回押してください。

#### ・明るさ設定 (Brightness)

「マーク」を長押しすることにより、ディスプレイの明るさの調整ができます。このモード設定は、測定していない場合でも、測定中でも設定が可能です。サブメニューに入り、輝度レベル1~5のどれかを選択し、ディスプレイの明るさを調節します。レベル5が最も明るく、レベル1が最も暗い設定になります。強い光の下で本製品を使用する場合は、明るい設定にしてください。電池を節約する場合は低い数値に設定にしてください。

#### ・初期設定に戻す (Default)

初期設定に戻します。初期設定では、輝度レベルが2になっています。



### 使用方法

- ① フロントパネルが上になるようにして、指の腹を下に向けて奥までしっかり指を入れてください。
- ② 指を入れると電源が自動で入ります。
- ③ 測定中の方の指と体が動かないようにしてください。
- ④ 脈拍信号を検知すると、本製品は血中酸素飽和度および脈拍を表示します。測定値は、検知する信号毎にアップデートされます。
- ⑤ 使用中に「マーク」ボタンを押すと、表示方向の変更ができます (4方向)。
- ⑥ 指が検知されない場合や指が抜かれた場合、「FingerOut」のメッセージが表示され、約7秒後に自動で電源が切れます。



### 予期される問題および解決策

問 題	予期される理由	解 決 策
電源が入らない	電池が切れている。 電池が正しく挿入されていない。 指が動いている。または、指が正しく挿入されていない。	電池を交換してください。 電池の向きを確認してください。 指を安定させてください。 または、指を機器に対し平行に真っ直ぐに挿入してください。
画面がロックしてしまう。または、画面に何も表示されない。 指に本製品を装着しているときに、波形や脈拍インジケータに動きがない。	有機ELディスプレイの故障。 電磁干渉 (EMI) 指が動いている。または、指が正しく挿入されていない。	使用を止めて販売店にご連絡ください。 周辺にある電子機器を遠ざけてください。 指を安定させてください。または、指を機器に対し平行に真っ直ぐに挿入してください。
SpO <sub>2</sub> 、または脈拍の測定値が表示されず、破線 (ダッシュ) が表示される。	脈拍信号の検知がうまくできていない。	脈拍強度表示バーが2本以下の場合は、以下を行ってください。 1. 測定している指の位置を変えてください。 2. 指を良くもんで温め

### 保守点検

### 製品仕様

### メンテナンス/保管

### 保証規定

### 保証書

商品名	パルスオキシメータ OXIBOY オキシボーイS-121      OXIGIRL オキシガールS-122 OXIYOUNG オキシヤングS-123      OXIROSA オキシローザS-125 OXIFRESH オキシフレッシュS-119
お買上げ年月日	年 月 日 (保証規定に従ってご購入日より1年間保証いたします)
ご購入者様	お名 前  ご住 所  電話番号
販売店様	お名 前  ご住 所  電話番号
製造販売元	

※製品の保証は、日本国内での使用に限ります。